


Rotating Anode X-Ray Tube  
 Tubes Radiogènes à Anode Tournante  
 Röntgenröhre mit rotierender Anode  
 Tubos de Rayos-X con Ánodo Giratorio



Note: Document originally drafted in the English language.

<b>Product Description</b>	<b>Description du Produit</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Descripcion del Producto</b>
<p>The G-1080 is a 4.25" (108 mm) 150 kV, 740 kJ (1.0 MHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This metal center section insert is designed for radiography, cineradiography, digital and film screen angiography procedures. The insert features a 10° rhenium-tungsten facing on molybdenum with a graphite backed target and is available with the following nominal focal spots:</p>	<p>Le tube G-1080, à anode tournante de 108 mm, (4,25 pouces), 150 kV, avec une capacité calorifique maximale de 740 kJ (1,0 MUC). Cette section métallique centrale a été conçue pour les procédures radiographiques, cinéradiographiques, et angiographiques numérisés et sur film. L'tube est pourvu d'une anode avec pente de 10° en rhénium - tungstène sur une base de molybdène et avec un doublage de graphite. Il est disponible avec les foyers suivantes:</p>	<p>Die G-1080 ist eine 4.25" (108 mm) Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicherkapazität von 740 kJ (1.0 MHU) und einer maximal Spannungsfestigkeit von 150 kV. Diese Einsatz mit metallischem Mittelteil wurde für Radiographie-, Röntgenkinematographie-, digitale und Filmangiographieverfahren entwickelt. Der rückseitig graphitbeschichtete Rhenium-Wolfram- und Molybdän Anodenteller besitzt einen Winkel von 10°. Folgende Brennfleck kombination ist lieferbar:</p>	<p>El G-1080 es un tubo de ánodo giratorio de 108 mm (4.25"), 150 kV, 740 kJ (1.0 MUC). Este tubo de metal en la parte central es diseñado específicamente para radiografía, cineradiográfica, digital, y procedimientos de angiografía con película de pantalla. El blanco emisor es una combinación de renio, tungsteno y molibdeno con grafito en la parte posterior con un rayo central de 10 grados. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:</p>
<p>0.6 - 1.0 IEC 60336</p>	<p>0,6 - 1,0 CEI 60336</p>	<p>0.6 - 1.0 IEC 60336</p>	<p>0.6 - 1.0 IEC 60336</p>
<p><b>Reference Axis:</b> Perpendicular to port face.</p>	<p><b>Référence Axe:</b> Perpendiculaire à la face de sortie.</p>	<p><b>Referenz Axes:</b> Senkrecht zum strahlenaustrittsfenster.</p>	<p><b>Referencia de Axes:</b> Perpendicular a la abertura facial.</p>
<p><b>Nominal Anode Input Power</b> Small - 53 kW IEC 60613 Large - 90 kW IEC 60613 For the equivalent anode input power of 235 Watt</p>	<p><b>Puissance anodique nominale de l'anode</b> Petit foyer - 53 kW CEI 60613 Grand foyer - 90 kW CEI 60613 Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 235 Watts</p>	<p><b>Nominale Anodenbezugsleistung</b> Klein - 53 kW IEC 60613 Gross - 90 kW IEC 60613 Gilt bei einer Aquivalent - Anodenleistung von 235 Watt</p>	<p><b>Potencia nominal de entrada del anodo</b> Foco fine - 53 kW IEC 60613 Foco grueso - 90 kW IEC 60613 Para una potencia equivalente del anodo de 235 W</p>
<p>This insert is intended for use in B-160H housings.</p>	<p>Ce tube est essentiellement destiné à être employé dans les gaines B-160H.</p>	<p>Die Röntgenröhre ist für den Einbau in die B-160H vorgesehen.</p>	<p>Este tubo es diseñado, para uso en los encajes B-160H.</p>
<p>G-1081 models have grid control capability.</p>	<p>Les Modèles G-1081 ont une fonction de commande de grille.</p>	<p>Modell G-1081 ist mit Gittersteuerungsfunktion ausgestattet.</p>	<p>El modelo G-1081 tiene capacidad para de rejillas controlar los electrones.</p>
<p>Grid Control Voltages: Typical Bias Voltage for Cutoff at 150 kV ..... -3700Vdc</p>	<p>Potentiel de controle de grille: Voltage typique pour coupure et 150 kV ..... -3700 Vcc</p>	<p>Gittersteuerspannungen: Typische Vorspannung für Abschaltung bei 150 kV ..... -3700Vdc</p>	<p>Voltaje de Rejillas Controlada: Voltaje controlado tipico con interruptor a 150 kV ..... -3700 Vdc</p>
<p>Grid Voltage for Exposure ..... 0 Vdc</p>	<p>Voltage de grille pendant exposition ..... 0 Vcc</p>	<p>Gitterspannung für Belichtung ..... 0 Vdc</p>	<p>Voltaje de rejillas con exponición ..... 0 Vdc</p>

Tube Outline Drawing  
Dessin d'Encombrement de la Tube  
Maßzeichnungen des Drehanoden-Röntgenröhre  
Esquema Detallado del Tubo

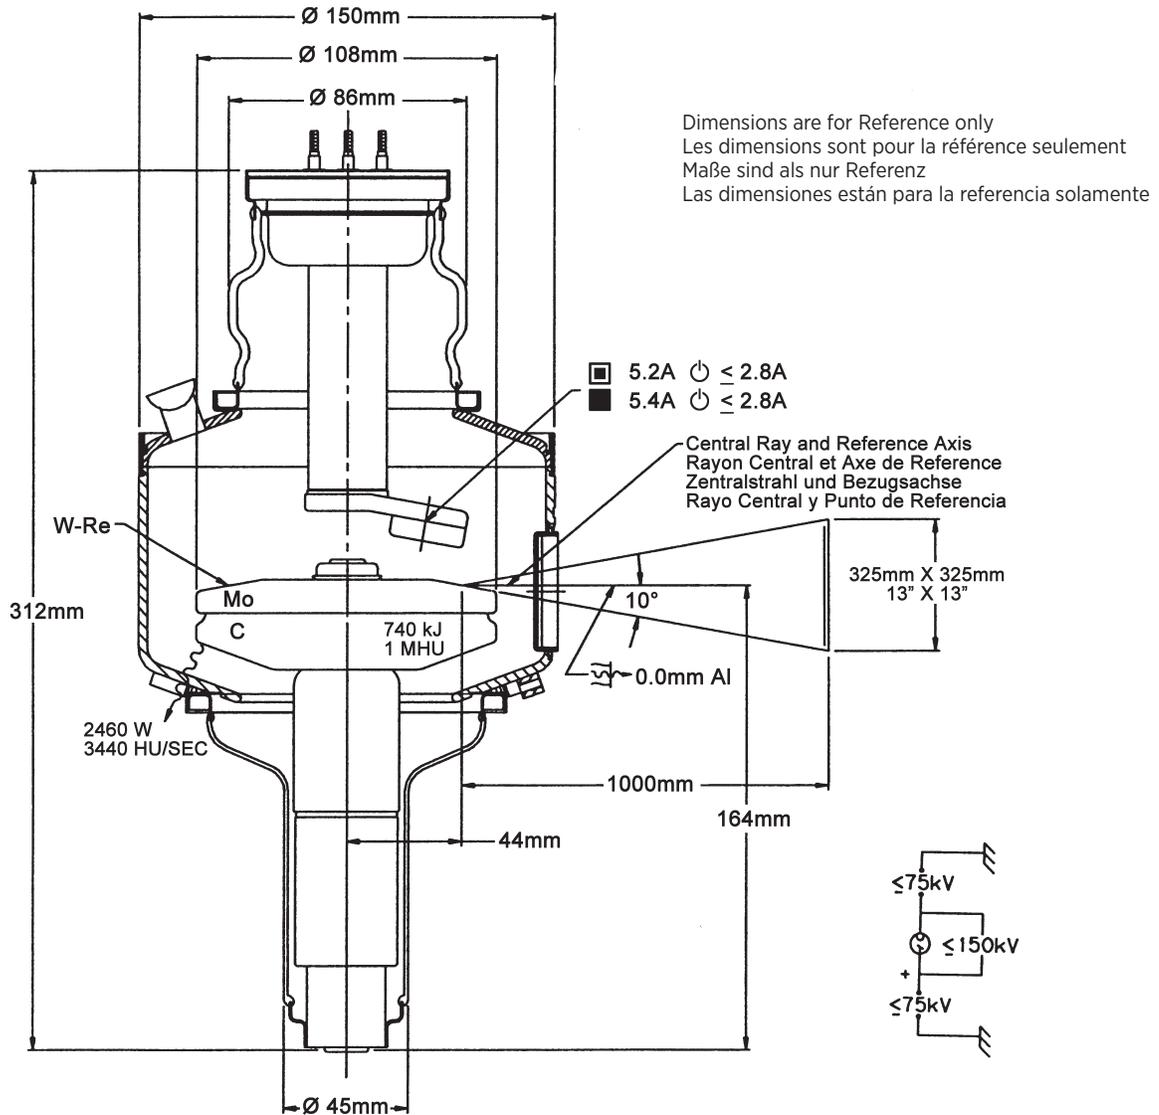

■ Large - Black  
 Grand - Noir  
 Gross - Schwarz  
 Largo - Negro

□ Small - White  
 Petit - Blanc  
 Klein - Weiss  
 Pequeño - Blanco



⏻ Stand - By  
 Attente  
 Bereit Stehen  
 En Espera

  
 Frame or Chasis  
 Masse  
 Chassis  
 Soporte o Chasis

  
 X-Ray Tube  
 Tube Radiogène  
 Röntgenröhre  
 Tubo de Rayos X

  
 Radiation Filter or Filtration  
 Filtre de rayonnement  
 Filterung  
 Filtración de Radiación

### 3 Ø Full Wave

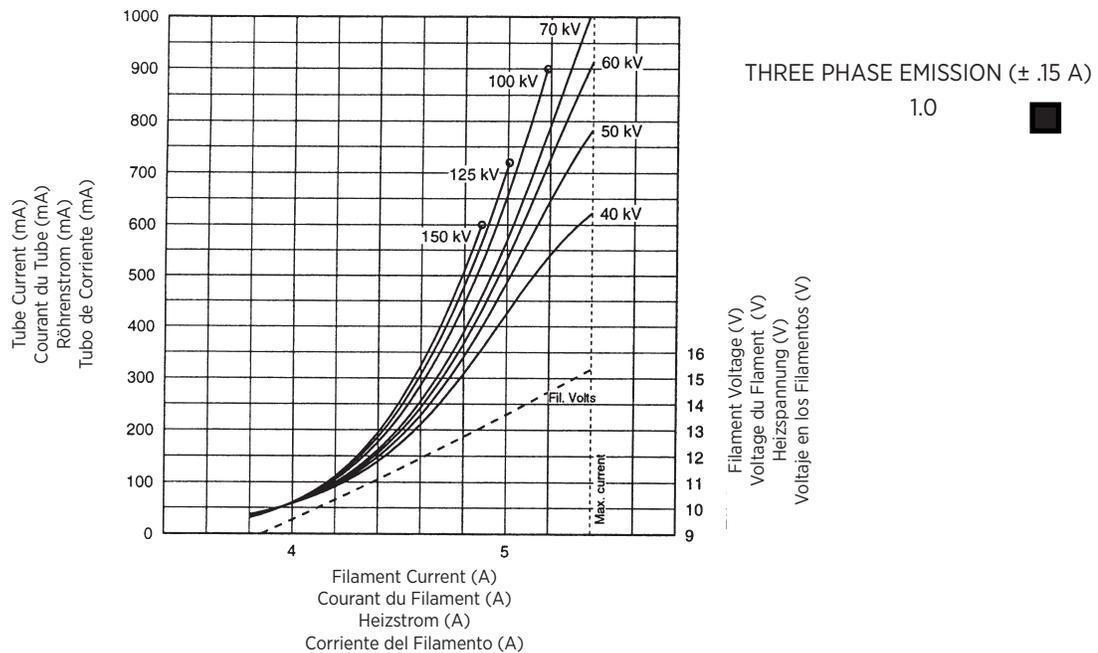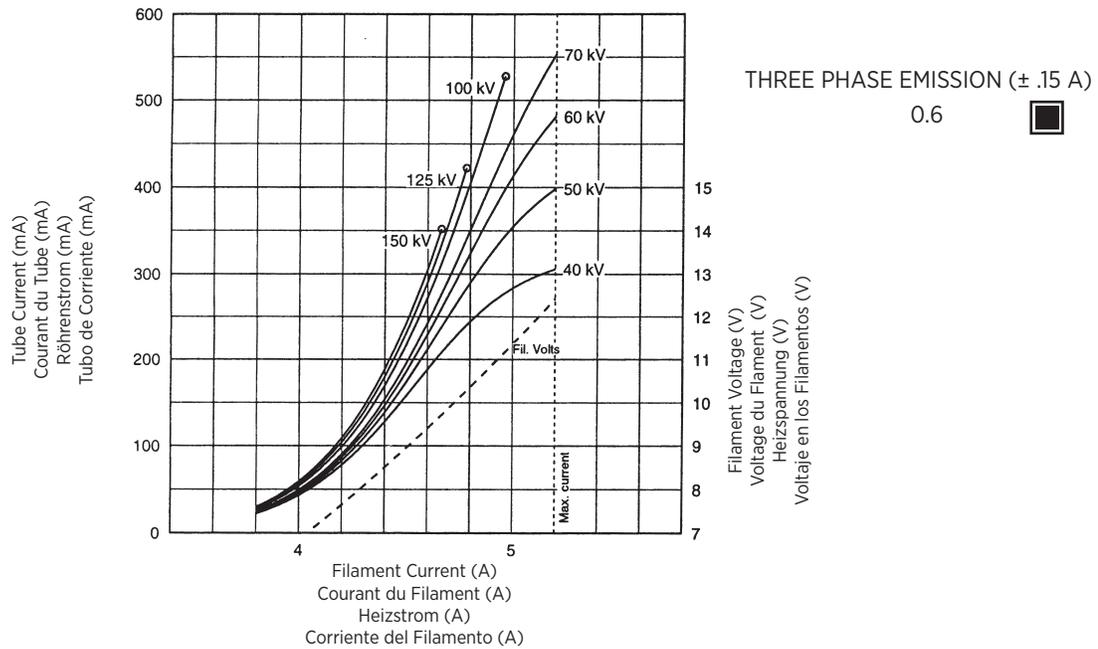

Note:  
 When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.

Remarque:  
 Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.


Anmerkung:  
 Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizstrom, und Anodendrehzahl.

Nota:  
 Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposición, y a las curvas de velocidad del objetivo.


3 Ø Constant Potential 

**50 Hz**

**Nominal Focal Spot Size - 0.6** 

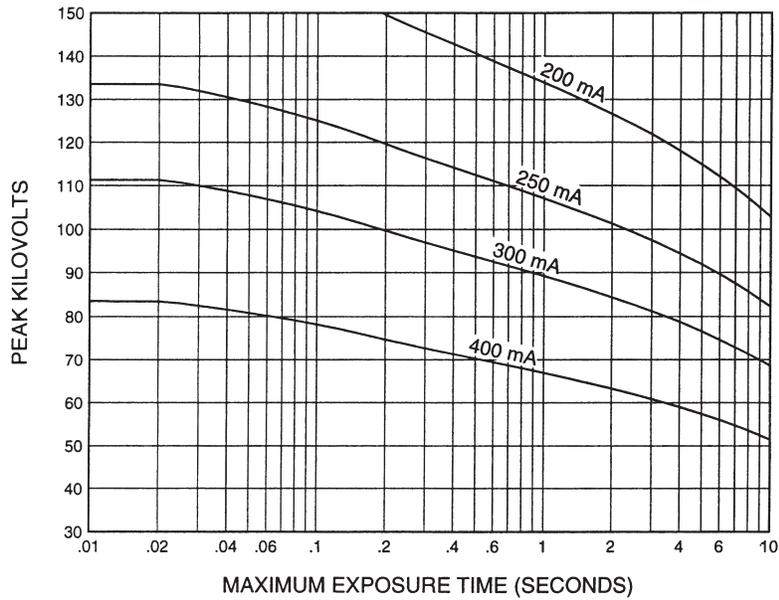

**Nominal Focal Spot Size - 1.0** 


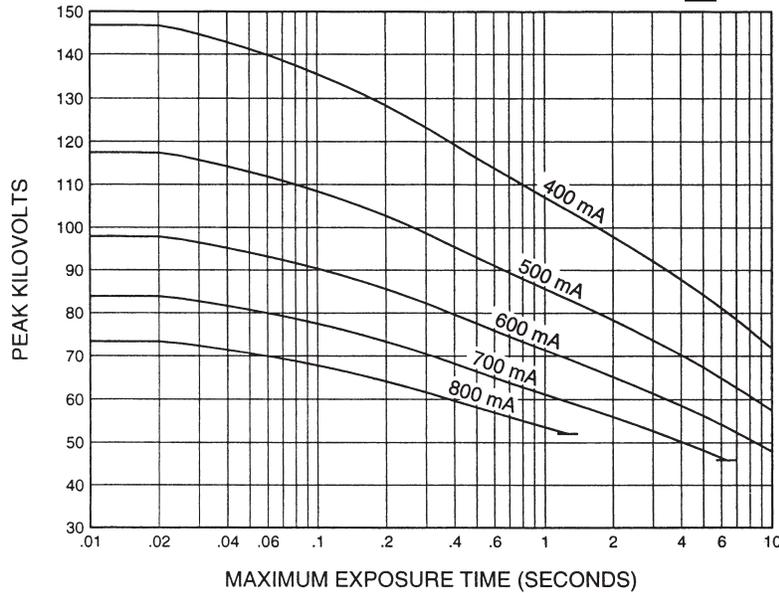


Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

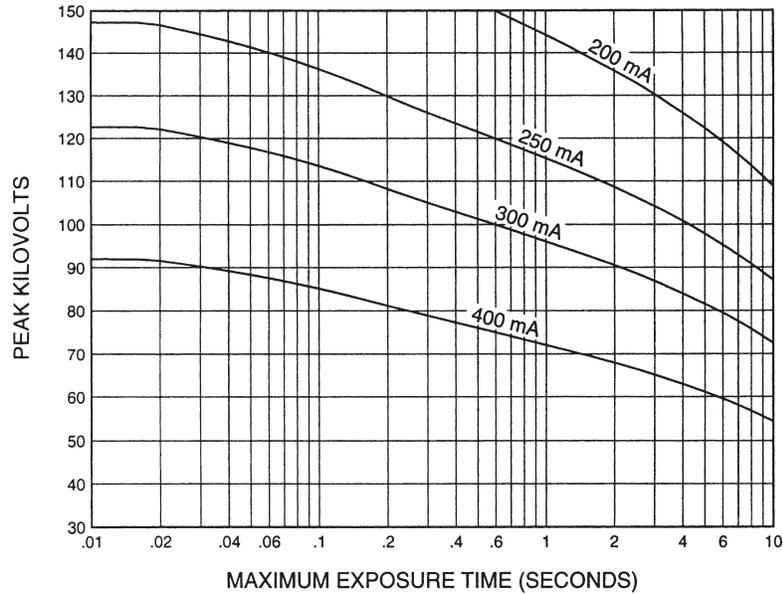
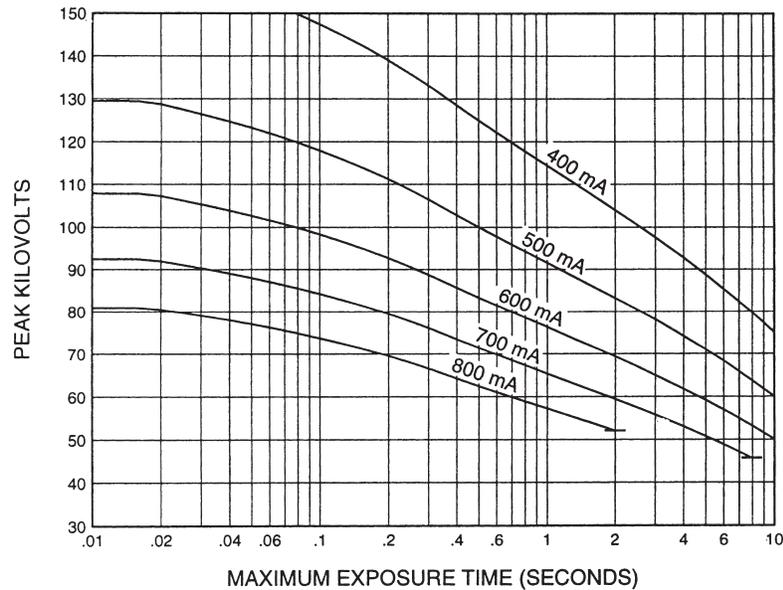
**3 Ø Constant Potential**
**60 Hz**
**Nominal Focal Spot Size - 0.6**

**Nominal Focal Spot Size - 1.0**


Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

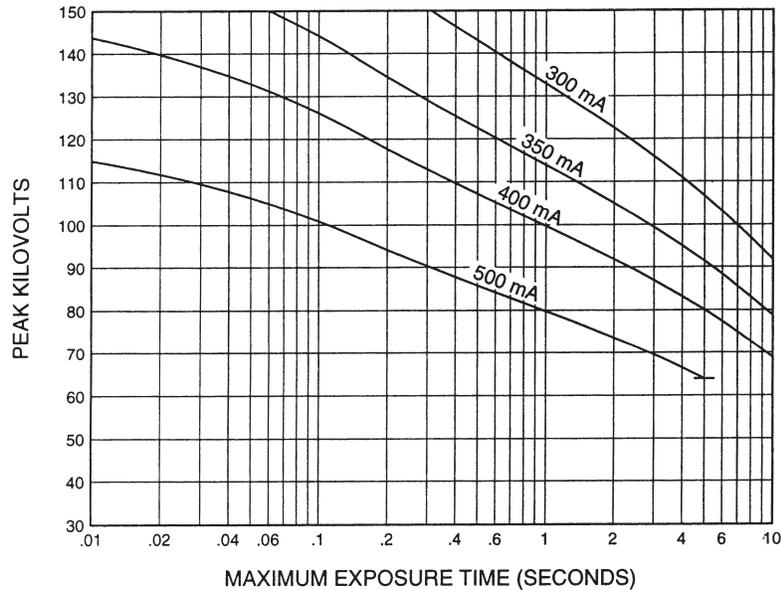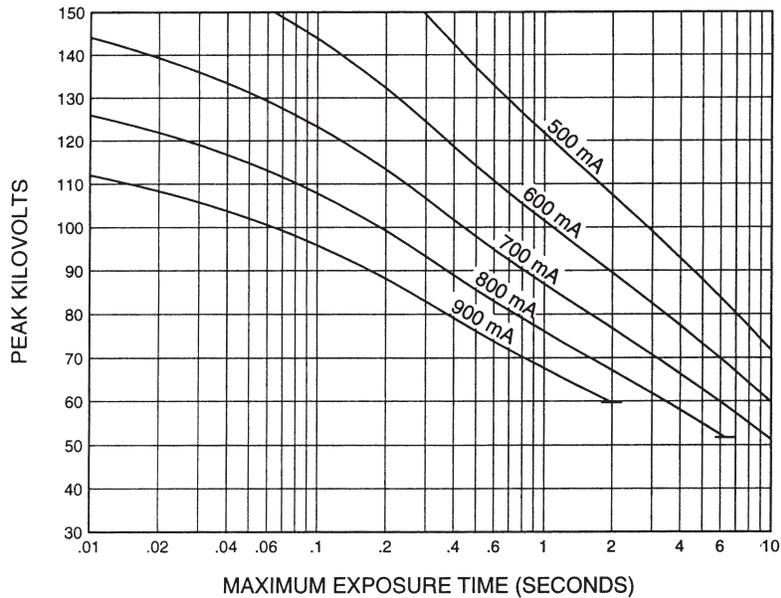Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

**3 Ø Constant Potential**
**150 Hz**
**Nominal Focal Spot Size - 0.6**

**Nominal Focal Spot Size - 1.0**


Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613


Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613


3 Ø Constant Potential 

**180 Hz**

**Nominal Focal Spot Size - 0.6** 

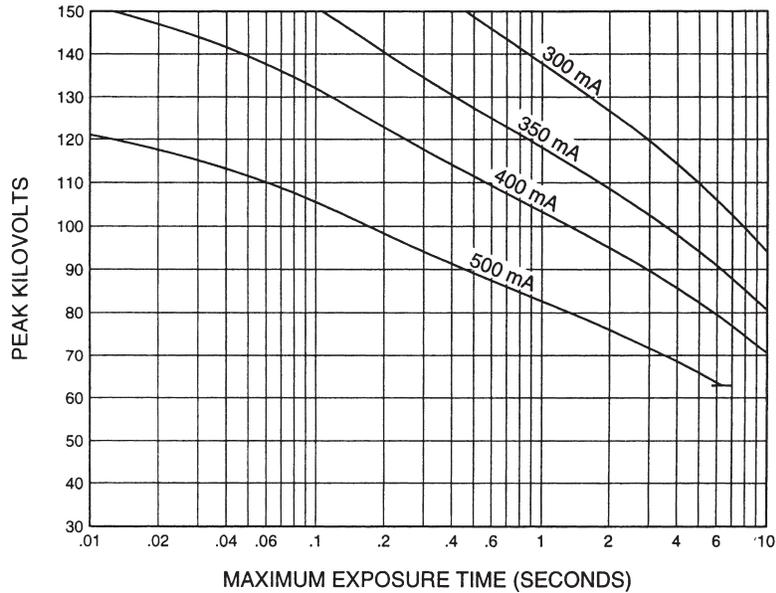

**Nominal Focal Spot Size - 1.0** 

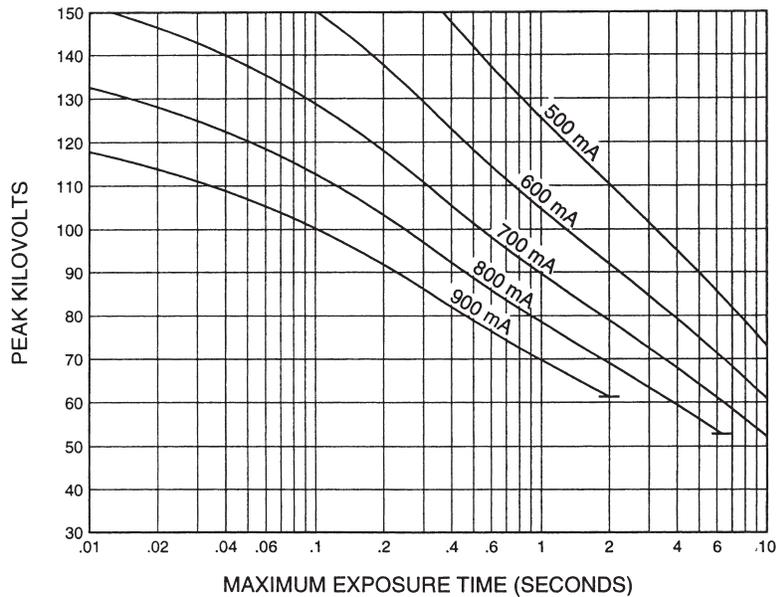

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

## CINERADIOGRAPHIC RATINGS

### HOW TO USE CINERADIOGRAPHIC CHARTS

**General:** With the Cineradiographic rating chart we can determine the maximum allowable kW of the Cine pulse, or with a given kW determine maximum time in seconds the Cine run can progress.

The Most common way of using the charts is to determine maximum time of any expected Cine run and maximum duty factor. With a known duty factor and Cine run time kW can easily be determined.

**Definition of Terms**

**Time in seconds:** Total time of one Cine run, usually 5 to 12 seconds.

**Duty Factor in Percent (DF%):** Actual time during one second the x-ray tube is producing x-rays. If we select a 5 msec pulse width and 50 exposures per second the x-ray tube will be producing x-rays for a total of 250 msec each second or 25% of the time. The higher the DF number, the more load placed on the x-ray tube

**Peak Pulse Power:** Peak energy in watts of any one Cine Pulse. Can be any combination of kV and mA allowed by Radiographic and Filament Emission curves.

Example:            80 kV at 400 mA equals  
  
                          80,000 V x 0.4 A = 32,000 W or 32 kW

**USING THE CINE RATING CHARTS:**

G-1080   150/160 Hz   3 Phase   1.0 Focal Spot

**Example:** Determine maximum kW allowed with the following known factors:  
Maximum Pulse Width ..... 5 msec  
Exposures per Second .....50  
Maximum Cine Run Time ....10 seconds

**Calculate Duty Factor:** (DF%)

$$DF\% = \frac{\text{Pulse Width (mSec)} \times \text{Frames per Second}}{10}$$

$$DF\% = \frac{5 \text{ msec} \times 50 \text{ exp/sec}}{10} = \frac{250}{10} = 25\%$$

Refer to Rating Chart G-1080   150/180 Hz   3 Phase  
1.0 Focal Spot:



At bottom of chart find 10 second line. Move vertically to intersection with 25% DF curve. Make a horizontal reference to left side of rating chart and note kW rating of 59 kW.

kW = kV x mA. The kW of the exposure can be any combination of mA and kW allowed by the Radiographic and Filament Emission Charts.



The Cine rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.

3 Ø Constant Potential  $\equiv$

50/60 Hz

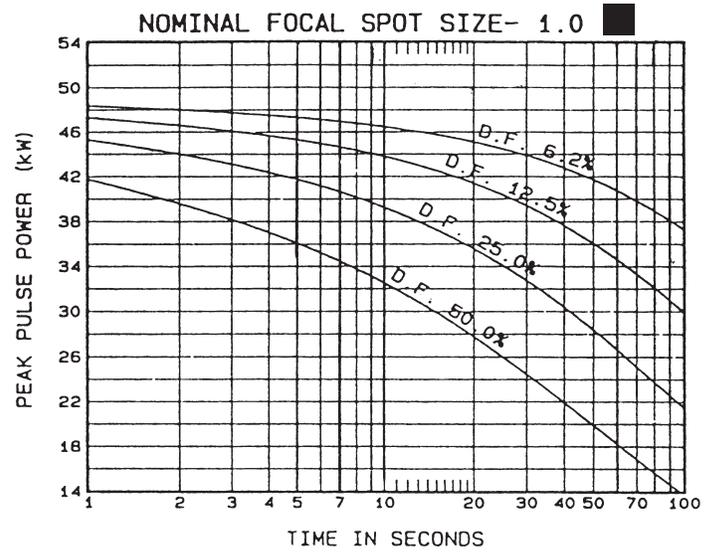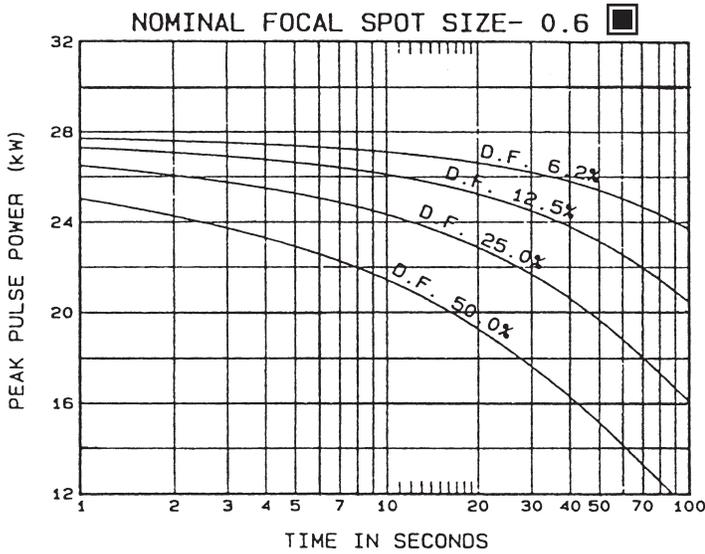

150/180 Hz

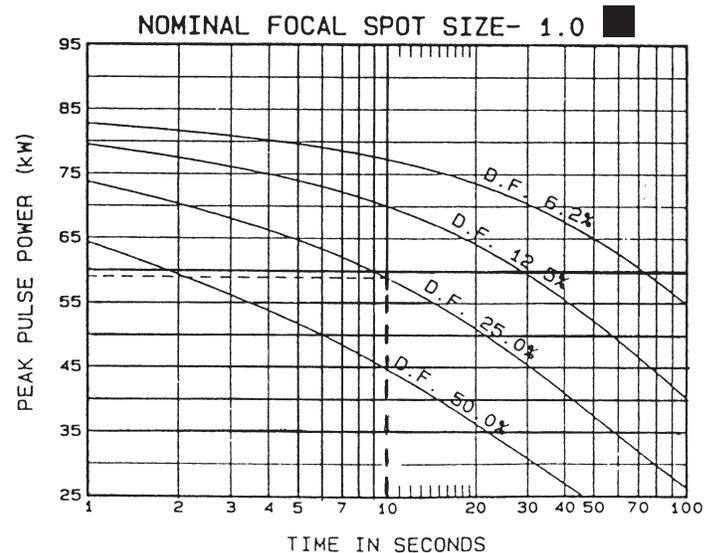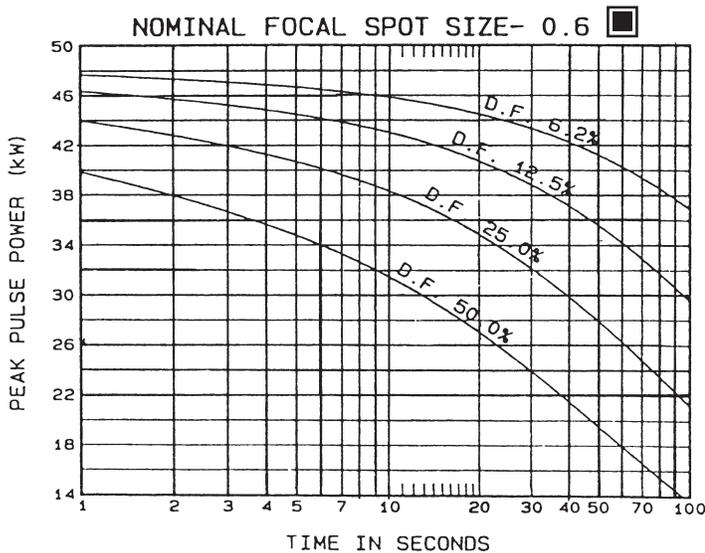

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

## ANGIOGRAPHIC RATINGS

### HOW TO USE ANGIOGRAPHIC CHARTS

**General:** Serial Radiography puts a severe demand on the x-ray tube due to the large number of exposures made in rapid succession. Intervals between exposures are fixed and so short that it is not possible for the anode track to cool to any extent during the exposure series. Therefore, the temperature of the anode track increases from exposure to exposure. The kW values used in the angiographic charts have been determined to prevent damage to the anode. The angiographic rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.

**Definition of Terms**

**Number of Exposures in Series:** The number of exposures made in succession or the number of exposures made during one contrast injection.

**Exposure Rate:** The number of exposures made per second. For a series of exposures where the exposure rate changes, it must be assumed that all exposures will be made at the maximum rate. For example, if during a series 10 exposures will occur at one per second and 30 exposures at 4 per second, use the kW ratings in the 40 exposure column at 4 per second rate.

**Exposure Time:** Time in seconds of each exposure.

**USING THE CHARTS:**

**Select Correct Chart:**

50/60 or 150/180 Hz

0.6 or 1.0 Focal Spot

**Note:** 1150/180 Hz rotor speed recommended for all angiography.

**Determine the number of exposures in Series:** With cut film angiography the number of exposures are known, however in Digital Angiography the number of exposures commonly are not known. When determining the number of exposures, assume worst case or past history.

**Note:** Most angiographic x-ray tubes fail from under-estimating the number of exposures made in a series.

**Determine kW of each exposure in Series:** Referring to chart —find block under “Number of Exposures in Series” that is greater than or equal to expected number of exposures in Series. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select maximum rate per second that will be used for the exposure series. At the intersection of exposure rate and exposure time in seconds, find maximum kW allowed for each exposure.

**kW = pkV x mA:** The kW of the exposure can be any combination of mA and pkV allowed by the Radiographic and Filament Emission charts.

For Example: 80 pkV and 500 mA = 40 kW

**Example:** From chart G-1080 150/180 Hz 3 Phase 1.0 Focal Spot, determine kW allowed with following known factors.  
 Maximum number of exposures .....40  
 Exposure time .050 second (50 milliseconds)  
 Maximum Exposure per second .....4

From chart find 40 exposure block. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select 4 exposures per second. Find .050 seconds at top of chart. At intersection of exposure rate line and exposure time, find 60.1 kW.

0.6 Focal Spot 3Ø 10 Degrees 50/60 Hz  
 0.6 Dimension Focale 3Ø 10 Degrés 50/60 Hz  
 0.6 Brennfleck 3Ø 10 Grad 50/60 Hz  
 0.6 De Marcas Focales 3Ø 10 Grados 50/60 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
 Abaques de charges successives CEI 60613  
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOGRAPHS OF THE SERIES															NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	28.0	27.9	27.5	27.1	26.7	26.4	25.8	25.4	24.9	24.5	24.2	23.8	23.5	23.1	22.8	10
2	28.0	27.8	27.3	26.9	26.5	26.1	25.5	25.0	24.5	24.0	23.6	23.2	22.9	22.5	22.1	
3	27.9	27.7	27.2	26.7	26.3	25.9	25.2	24.6	24.1	23.6	23.1	22.7	—	—	—	
4	27.9	27.6	27.0	26.5	26.1	25.6	24.9	24.3	23.7	23.2	—	—	—	—	—	
8	27.7	27.2	26.5	25.9	25.3	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	27.4	26.7	25.8	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	27.0	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	27.9	27.7	27.2	26.8	26.3	26.0	25.3	24.7	24.2	23.7	23.2	22.8	22.4	21.9	21.5	20
2	27.9	27.6	27.0	26.5	26.1	25.6	24.9	24.2	23.6	23.1	22.6	22.1	21.7	21.2	20.7	
3	27.8	27.5	26.9	26.3	25.8	25.3	24.5	23.8	23.1	22.5	22.0	21.5	—	—	—	
4	27.7	27.4	26.7	26.1	25.5	25.0	24.2	23.4	22.7	22.1	—	—	—	—	—	
8	27.5	26.9	26.0	25.3	24.6	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	27.1	26.2	25.1	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	26.5	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	27.8	27.4	26.8	26.2	25.7	25.2	24.4	23.6	22.9	22.3	21.7	21.1	20.6	20.0	19.5	40
2	27.7	27.3	26.6	25.9	25.4	24.8	23.9	23.1	22.3	21.6	21.0	20.4	19.9	19.3	18.7	
3	27.6	27.1	26.4	25.7	25.1	24.5	23.5	22.6	21.8	21.1	20.4	19.8	—	—	—	
4	27.6	27.0	26.2	25.4	24.8	24.2	23.1	22.1	21.3	20.5	—	—	—	—	—	
8	27.3	26.5	25.4	24.5	23.7	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	26.8	25.7	24.4	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	26.1	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	27.6	27.2	26.4	25.7	25.1	24.5	23.5	22.6	21.8	21.1	20.4	19.7	19.2	18.5	17.9	60
2	27.6	27.0	26.2	25.4	24.8	24.1	23.1	22.1	21.2	20.4	19.7	19.1	18.5	17.8	17.1	
3	27.5	26.8	26.0	25.2	24.4	23.8	22.6	21.6	20.7	19.9	19.1	18.4	—	—	—	
4	27.4	26.7	25.8	24.9	24.1	23.4	22.2	21.1	20.2	19.3	—	—	—	—	—	
8	27.1	26.1	24.9	23.9	23.0	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	26.6	25.2	23.8	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	25.8	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	27.5	26.9	26.0	25.2	24.5	23.9	22.7	21.7	20.8	20.0	19.2	18.5	17.9	17.2	16.6	80
2	27.4	26.7	25.8	25.0	24.2	23.5	22.3	21.2	20.2	19.4	18.6	17.9	17.3	16.5	15.9	
3	27.3	26.6	25.6	24.7	23.9	23.1	21.8	20.7	19.7	18.8	18.0	17.3	—	—	—	
4	27.2	26.4	25.4	24.4	23.6	22.8	21.4	20.3	19.2	18.3	—	—	—	—	—	
8	26.9	25.8	24.5	23.4	22.4	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	26.4	24.9	23.3	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	25.5	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	27.4	26.6	25.7	24.8	24.0	23.3	22.0	20.9	19.9	19.0	18.2	17.5	16.8	15.9	14.3	100
2	27.3	26.5	25.4	24.5	23.7	22.9	21.6	20.4	19.4	18.5	17.6	16.9	16.2	15.5	14.3	
3	27.2	26.3	25.2	24.2	23.3	22.5	21.1	19.9	18.9	17.9	17.1	16.3	—	—	—	
4	27.1	26.1	25.0	23.9	23.0	22.2	20.7	19.5	18.4	17.5	—	—	—	—	—	
8	26.8	25.5	24.1	22.9	21.9	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	26.2	24.6	22.9	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	25.3	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	27.0	26.0	24.8	23.7	22.8	21.9	20.4	19.1	18.0	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	150
2	26.9	25.8	24.6	23.5	22.5	21.6	20.0	18.7	17.5	16.5	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	
3	26.8	25.7	24.4	23.2	22.1	21.2	19.6	18.2	17.1	16.1	14.9	13.2	—	—	—	
4	26.8	25.5	24.1	22.9	21.8	20.9	19.2	17.8	16.7	15.6	—	—	—	—	—	
8	26.4	24.9	23.3	21.9	20.7	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	25.8	23.9	22.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	24.8	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

**Note:**  
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**  
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**  
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**  
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.6 Focal Spot 3Ø 10 Degrees 150/180 Hz  
 0.6 Dimension Focale 3Ø 10 Degrés 150/180 Hz  
 0.6 Brennfleck 3Ø 10 Grad 150/180 Hz  
 0.6 De Marcas Focales 3Ø 10 Grados 150/180 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
 Abaques de charges successives CEI 60613  
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOGRAPHS OF THE SERIES															NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	48.1	46.4	45.2	44.2	43.4	42.6	41.2	40.0	39.0	38.0	37.1	36.3	35.6	34.8	34.1	10
2	47.9	46.2	44.8	43.7	42.8	41.9	40.4	39.0	37.9	36.8	35.9	35.0	34.2	33.3	32.5	
3	47.8	45.9	44.5	43.3	42.2	41.3	39.6	38.2	36.9	35.8	34.7	33.8	—	—	—	
4	47.6	45.6	44.1	42.8	41.7	40.6	38.9	37.3	36.0	34.8	—	—	—	—	—	
8	47.1	44.6	42.7	41.1	39.7	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	46.3	43.2	40.9	38.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	45.1	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	47.8	46.0	44.6	43.4	42.4	41.5	39.8	38.4	37.1	36.0	35.0	34.0	33.2	32.2	31.3	20
2	47.6	45.6	44.1	42.8	41.7	40.7	38.8	37.3	35.9	34.7	33.5	32.5	31.6	30.5	29.6	
3	47.5	45.3	43.6	42.2	41.0	39.9	37.9	36.2	34.8	33.5	32.3	31.2	—	—	—	
4	47.3	45.0	43.2	41.7	40.4	39.2	37.1	35.3	33.8	32.4	—	—	—	—	—	
8	46.6	43.7	41.5	39.7	38.0	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	45.6	42.0	39.3	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	43.9	39.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	47.4	45.2	43.5	42.0	40.8	39.6	37.5	35.8	34.2	32.8	31.6	30.4	29.4	28.3	27.2	40
2	47.2	44.8	42.9	41.3	40.0	38.7	36.5	34.6	32.9	31.5	30.2	29.0	27.9	26.7	25.6	
3	47.0	44.4	42.4	40.7	39.2	37.8	35.5	33.5	31.8	30.3	28.9	27.7	—	—	—	
4	46.7	44.0	41.9	40.1	38.5	37.1	34.6	32.5	30.8	29.2	—	—	—	—	—	
8	45.9	42.6	40.0	37.8	35.9	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	44.7	40.6	37.4	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	42.6	37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	47.0	44.5	42.5	40.8	39.3	37.9	35.6	33.6	31.8	30.3	28.9	27.7	26.5	25.3	23.8	60
2	46.8	44.0	41.9	40.1	38.5	37.0	34.5	32.4	30.6	29.0	27.6	26.3	25.2	23.9	22.8	
3	46.5	43.6	41.3	39.4	37.7	36.2	33.6	31.4	29.5	27.9	26.4	25.2	—	—	—	
4	46.3	43.2	40.8	38.7	37.0	35.4	32.7	30.4	28.5	26.8	—	—	—	—	—	
8	45.4	41.7	38.8	36.4	34.4	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	44.1	39.5	36.1	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	41.8	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	46.6	43.8	41.5	39.6	37.9	36.4	33.8	31.6	29.8	28.1	26.6	24.8	22.3	19.9	17.9	80
2	46.3	43.3	40.9	38.9	37.1	35.5	32.8	30.5	28.6	26.9	25.5	24.2	22.3	19.9	17.9	
3	46.1	42.9	40.3	38.2	36.3	34.7	31.9	29.6	27.6	25.9	24.4	23.1	—	—	—	
4	45.8	42.5	39.8	37.6	35.6	33.9	31.0	28.7	26.7	25.0	—	—	—	—	—	
8	44.9	40.9	37.8	35.2	33.1	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	43.5	38.7	35.0	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	41.1	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	46.2	43.1	40.6	38.5	36.7	35.0	32.3	29.9	28.0	25.5	22.3	19.9	17.9	15.9	14.3	100
2	45.9	42.6	40.0	37.8	35.9	34.2	31.3	28.9	26.9	25.2	22.3	19.9	17.9	15.9	14.3	
3	45.7	42.2	39.4	37.1	35.1	33.4	30.4	28.0	25.9	24.2	22.3	19.9	—	—	—	
4	45.4	41.8	38.9	36.5	34.4	32.6	29.6	27.1	25.1	23.4	—	—	—	—	—	
8	44.5	40.2	36.9	34.2	31.9	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	43.1	37.9	34.1	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	40.6	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	45.3	41.5	38.5	36.0	33.9	32.0	28.9	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	150
2	45.0	41.0	37.9	35.4	33.2	31.3	28.1	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	
3	44.7	40.6	37.4	34.7	32.5	30.5	27.3	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	—	—	—	
4	44.5	40.2	36.8	34.1	31.8	29.8	26.6	23.8	19.9	17.0	—	—	—	—	—	
8	43.5	38.6	34.9	31.9	29.5	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	42.0	36.3	32.2	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	39.4	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

**Note:**  
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**  
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**  
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**  
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

1.0 Focal Spot  $\varnothing$  10 Degrees 50/60 Hz  
 1,0 Dimension Focale  $\varnothing$  10 Degrés 50/60 Hz  
 1.0 Brennfleck  $\varnothing$  10 Grad 50/60 Hz  
 1.0 De Marcas Focales  $\varnothing$  10 Grados 50/60 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
 Abaques de charges successives CEI 60613  
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOGRAPHS OF THE SERIES															NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	49.1	48.7	47.7	46.8	46.0	45.2	43.9	42.8	41.8	40.8	40.0	39.2	38.4	37.5	36.7	10
2	48.9	48.4	47.2	46.2	45.3	44.4	42.9	41.6	40.5	39.4	38.4	37.5	36.7	35.7	34.8	
3	48.8	48.1	46.8	45.6	44.6	43.7	42.0	40.6	39.3	38.2	37.1	36.1	—	—	—	
4	48.6	47.8	46.4	45.2	44.0	43.0	41.2	39.6	38.3	37.0	—	—	—	—	—	
8	48.2	46.9	45.2	43.6	42.2	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	47.6	45.8	43.7	41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	46.8	44.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	48.9	48.2	47.0	45.9	44.9	44.0	42.4	41.0	39.7	38.5	37.5	36.5	35.5	34.5	33.5	20
2	48.7	47.8	46.4	45.2	44.0	43.0	41.2	39.6	38.2	36.9	35.7	34.7	33.7	32.5	31.5	
3	48.4	47.4	45.9	44.5	43.2	42.1	40.1	38.4	36.9	35.5	34.3	33.1	—	—	—	
4	48.3	47.1	45.4	43.9	42.5	41.3	39.2	37.3	35.7	34.2	—	—	—	—	—	
8	47.7	46.0	43.8	41.9	40.3	38.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	46.8	44.4	41.7	39.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	45.5	42.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	48.4	47.4	45.8	44.3	43.0	41.9	39.8	38.0	36.4	34.9	33.6	32.4	31.3	30.0	28.8	40
2	48.2	46.9	45.1	43.5	42.1	40.8	38.5	36.6	34.8	33.3	31.9	30.7	29.5	28.2	27.0	
3	47.9	46.4	44.5	42.8	41.2	39.8	37.4	35.3	33.5	31.9	30.5	29.2	—	—	—	
4	47.7	46.1	44.0	42.1	40.4	39.0	36.4	34.2	32.3	30.7	—	—	—	—	—	
8	46.9	44.7	42.1	39.8	37.9	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	45.9	42.7	39.6	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	44.1	39.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	48.0	46.5	44.6	42.9	41.4	40.0	37.6	35.5	33.6	32.0	30.5	29.2	28.0	26.5	23.8	60
2	47.7	46.1	44.0	42.1	40.4	38.9	36.3	34.1	32.2	30.5	29.0	27.7	26.5	25.1	23.8	
3	47.5	45.6	43.3	41.3	39.5	38.0	35.2	32.9	30.9	29.2	27.7	26.3	—	—	—	
4	47.2	45.2	42.7	40.6	38.8	37.1	34.2	31.8	29.8	28.1	—	—	—	—	—	
8	46.4	43.7	40.8	38.3	36.1	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	45.2	41.6	38.1	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	43.2	38.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	47.6	45.8	43.6	41.6	39.9	38.3	35.6	33.3	31.3	29.6	27.9	24.8	22.3	19.9	17.9	80
2	47.3	45.3	42.9	40.8	38.9	37.3	34.5	32.1	30.0	28.2	26.7	24.8	22.3	19.9	17.9	
3	47.0	44.8	42.2	40.0	38.1	36.3	33.4	30.9	28.8	27.0	25.5	24.1	—	—	—	
4	46.8	44.3	41.7	39.3	37.3	35.5	32.4	29.9	27.8	26.0	—	—	—	—	—	
8	45.9	42.8	39.6	37.0	34.7	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	44.6	40.6	36.9	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	42.5	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	47.2	45.0	42.6	40.4	38.5	36.8	33.9	31.4	29.3	25.5	22.3	19.9	17.9	15.9	14.3	100
2	46.9	44.5	41.9	39.6	37.6	35.8	32.8	30.3	28.1	25.5	22.3	19.9	17.9	15.9	14.3	
3	46.6	44.0	41.2	38.8	36.7	34.9	31.8	29.2	27.1	25.2	22.3	19.9	—	—	—	
4	46.3	43.6	40.7	38.1	36.0	34.1	30.8	28.2	26.1	24.2	—	—	—	—	—	
8	45.4	42.0	38.6	35.8	33.4	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	44.1	39.8	35.9	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	41.9	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	46.2	43.3	40.3	37.7	35.4	33.5	29.8	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	150
2	45.9	42.8	39.6	36.9	34.6	32.6	29.3	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	
3	45.6	42.3	39.0	36.2	33.8	31.8	28.4	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	—	—	—	
4	45.3	41.8	38.4	35.5	33.1	31.0	27.6	23.8	19.9	17.0	—	—	—	—	—	
8	44.4	40.3	36.4	33.3	30.7	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	43.0	38.0	33.7	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	40.6	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

**Note:**  
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**  
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**  
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**  
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

1.0 Focal Spot 3Ø 10 Degrees 150/180 Hz  
 1,0 Dimension Focale 3Ø 10 Degrés 150/180 Hz  
 1.0 Brennfleck 3Ø 10 Grad 150/180 Hz  
 1.0 De Marcas Focales 3Ø 10 Grados 150/180 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
 Abaques de charges successives CEI 60613  
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOGRAPHS OF THE SERIES															NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	83.9	80.2	77.4	75.2	73.2	71.4	68.3	65.6	63.3	61.2	59.3	57.6	56.0	54.1	52.4	10
2	83.4	79.3	76.2	73.6	71.4	69.4	65.9	62.9	60.3	58.0	56.0	54.1	52.4	50.4	48.7	
3	82.9	78.4	75.1	72.2	69.8	67.6	63.8	60.6	57.8	55.4	53.2	51.2	—	—	—	
4	82.5	77.8	74.1	71.1	68.4	66.0	61.9	58.5	55.6	53.0	—	—	—	—	—	
8	81.2	75.4	71.0	67.3	64.1	61.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	79.5	72.6	67.3	62.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	77.4	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	83.1	78.8	75.6	72.9	70.5	68.3	64.6	61.4	58.6	56.1	53.9	51.9	50.1	48.0	46.1	20
2	82.5	77.8	74.1	71.1	68.4	66.0	61.9	58.4	55.4	52.8	50.4	48.3	46.4	44.3	42.4	
3	82.0	76.7	72.8	69.4	66.5	63.9	59.5	55.8	52.7	49.9	47.5	45.4	—	—	—	
4	81.5	75.9	71.6	68.0	64.9	62.1	57.4	53.5	50.3	47.5	—	—	—	—	—	
8	79.7	72.9	67.7	63.4	59.8	56.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	77.3	69.1	62.8	57.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	73.8	63.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	81.8	76.5	72.4	69.0	66.0	63.3	58.7	54.9	51.6	48.8	46.2	44.0	42.0	39.7	35.8	40
2	81.1	75.3	70.8	67.1	63.8	61.0	56.1	52.0	48.6	45.7	43.1	40.9	38.9	36.6	34.7	
3	80.5	74.2	69.3	65.3	61.8	58.8	53.7	49.5	46.1	43.1	40.5	38.3	—	—	—	
4	79.9	73.2	68.0	63.8	60.1	56.9	51.6	47.3	43.8	40.9	—	—	—	—	—	
8	77.8	69.7	63.6	58.7	54.6	51.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	74.8	65.1	58.1	52.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	70.2	58.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	80.6	74.4	69.6	65.6	62.2	59.2	54.0	49.8	46.3	42.6	37.2	33.1	29.8	26.5	23.8	60
2	79.9	73.2	68.0	63.7	60.1	56.9	51.6	47.2	43.7	40.6	37.2	33.1	29.8	26.5	23.8	
3	79.1	72.0	66.5	62.0	58.1	54.8	49.3	45.0	41.4	38.3	35.8	33.1	—	—	—	
4	78.5	70.9	65.2	60.4	56.5	53.0	47.4	42.9	39.4	36.4	—	—	—	—	—	
8	76.2	67.3	60.7	55.4	51.1	47.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	73.0	62.5	54.9	49.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	67.9	55.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	79.4	72.5	67.1	62.6	58.9	55.6	50.1	44.7	37.2	31.9	27.9	24.8	22.3	19.9	17.9	80
2	78.7	71.2	65.5	60.8	56.8	53.4	47.8	43.4	37.2	31.9	27.9	24.8	22.3	19.9	17.9	
3	77.9	70.0	64.0	59.1	55.0	51.5	45.8	41.3	37.2	31.9	27.9	24.8	—	—	—	
4	77.3	68.9	62.7	57.6	53.4	49.8	44.0	39.5	35.9	31.9	—	—	—	—	—	
8	74.9	65.3	58.2	52.7	48.2	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	71.5	60.3	52.5	46.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	66.2	53.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	78.3	70.6	64.7	59.9	55.9	52.4	44.7	35.8	29.8	25.5	22.3	19.9	17.9	15.9	14.3	100
2	77.5	69.4	63.2	58.2	54.0	50.4	44.7	35.8	29.8	25.5	22.3	19.9	17.9	15.9	14.3	
3	76.8	68.2	61.7	56.5	52.2	48.6	42.8	35.8	29.8	25.5	22.3	19.9	—	—	—	
4	76.1	67.1	60.4	55.1	50.7	47.0	41.2	35.8	29.8	25.5	—	—	—	—	—	
8	73.7	63.5	56.1	50.4	45.8	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	70.3	58.5	50.4	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	64.7	51.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	75.7	66.4	59.6	54.1	47.7	39.7	29.8	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	150
2	74.9	65.2	58.1	52.6	47.7	39.7	29.8	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	11.9	10.6	9.5	
3	74.1	64.1	56.8	51.1	46.6	39.7	29.8	23.8	19.9	17.0	14.9	13.2	—	—	—	
4	73.5	63.1	55.6	49.8	45.2	39.7	29.8	23.8	19.9	17.0	—	—	—	—	—	
8	71.0	59.5	51.6	45.6	40.9	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	67.5	54.7	46.3	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	61.8	47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

**Note:**  
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**  
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**  
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**  
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.


Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

Anode Heating & Cooling Chart  
 Abaquos d' Échauffement et de Refroidissement de L'Anode  
 Anoden Aufheiz - und Abkühl Kurven  
 Curvas de Calentamiento y Enfriamiento del Anodo

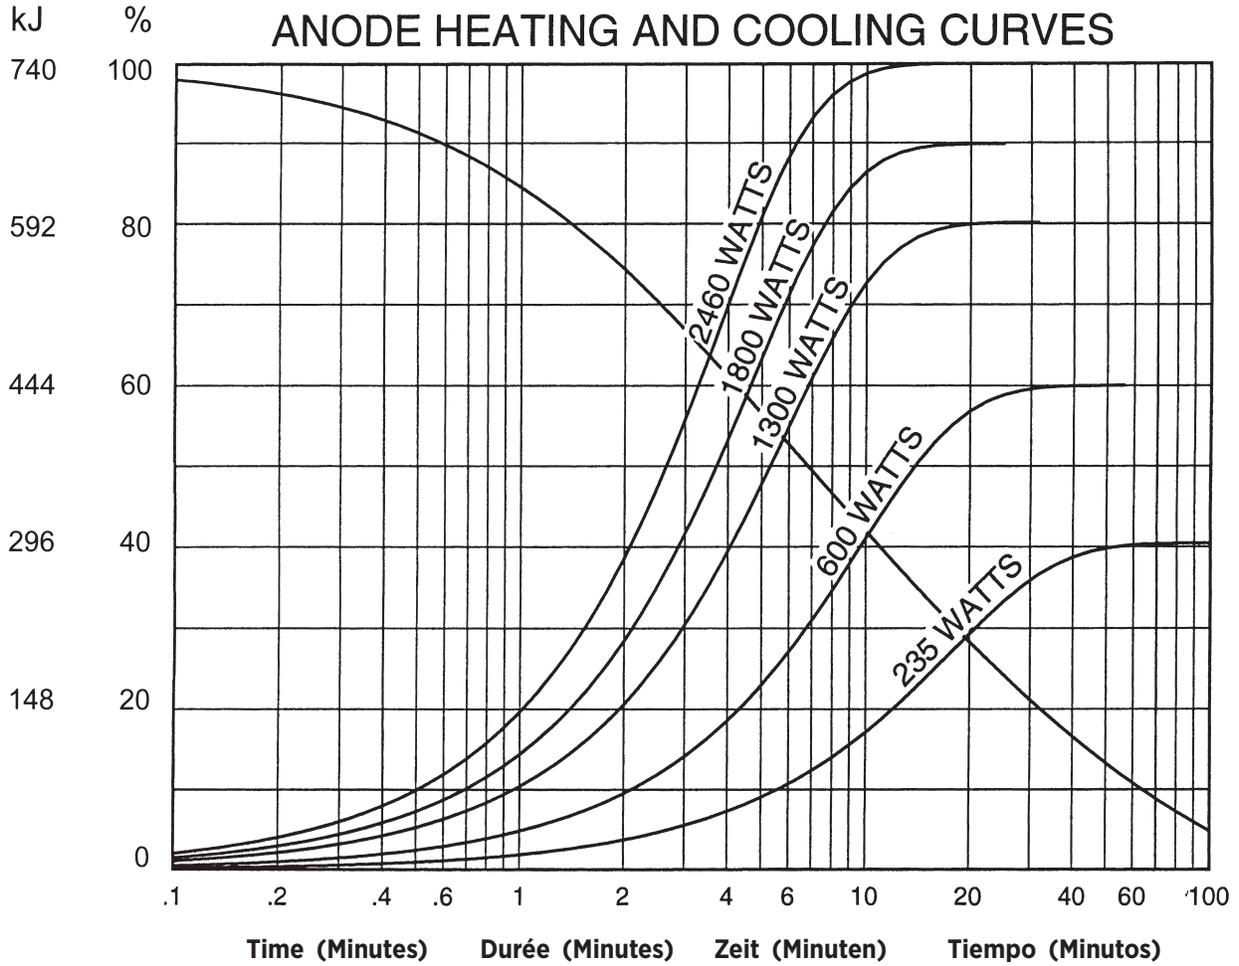



Salt Lake City, UT 1-801-972-5000

*For a complete listing of our global offices,  
visit [www.vareximaging.com](http://www.vareximaging.com)*

Manufactured by Varex Imaging Corporation  
Fabrique par Varex Imaging Corporation  
Hergestellt von Varex Imaging Corporation  
Fabricado por Varex Imaging Corporation

Specifications subject to change without notice.  
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Technische Daten ohne Gewähr.  
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.